

Inhaltsverzeichnis

Prüfstifte mit und ohne Halter


Prüfstifte aus Hartmetall	2-3
Prüfstifte aus Hartmetall mit Halter	4-5
Prüfstifte aus Hartmetall mit Entlüftungsloch für Sacklöcher	6-7
Prüfstifte aus Hartmetall mit Entlüftungsloch für Sacklöcher mit Halter	8-9
Halter für Hartmetallprüfstifte	10

Prüfstifte aus Hartmetall

Werkskalibrierschein



Pos.	Nominaldurchmesser	Sollwert (mm)	Istwert (mm)		Mittelwert (mm)	Bestellnummer
	Ø Tol. +/-0.0005 mm		1	2		
	0.2110	0.2110	0.2112	0.2113	0.21125	7501.0211.070



Artikel-Nr.	Inhalt	Ø Bereich (mm)	Steigung	Toleranz (mm)	Länge (mm)	
7501	95	0,05 - 1,00	0,01	± 0,0005	70	inklusive Aufbewahrungskasten 105 x 140 x 240 mm
7511	100	1,01 - 2,00	0,01	± 0,0005	70	

Ausführung: Die Prüfstifte werden in Laserbeschrifteten Kunststoffröhrchen und mit Prüfprotokoll geliefert.
Der Inhalt kann nach Ihren Angaben zusammengestellt werden.
Die Prüfstifte sind auch einzeln erhältlich.


Prüfstifte aus Hartmetall




Steigung 0,001 mm		Länge 70 mm
Ø Tol. +/-0.0005mm	Ø Außen	Bestellnummer
	0,050	7501.0050.070
	0,051	7501.0051.070
	0,052	7501.0052.070
	0,053	7501.0053.070
	0,054	7501.0054.070
	0,055	7501.0055.070
↓	↓	↓
	0,099	7501.0099.070
	0,100	7501.0100.070
	0,101	7501.0101.070
	0,102	7501.0102.070
	0,103	7501.0103.070
	0,104	7501.0104.070
↓	↓	↓
	0,994	7501.0994.070
	0,995	7501.0995.070
	0,996	7501.0996.070
	0,997	7501.0997.070
	0,998	7501.0998.070
	0,999	7501.0999.070

Steigung 0,001 mm		Länge 70 mm
Ø Tol. +/-0.0005mm	Ø Außen	Bestellnummer
	1,000	7501.1000.070
	1,001	7501.1001.070
	1,002	7501.1002.070
	1,003	7501.1003.070
	1,004	7501.1004.070
	1,005	7501.1005.070
↓	↓	↓
	1,099	7501.1099.070
	1,100	7501.1100.070
	1,101	7501.1101.070
	1,102	7501.1102.070
	1,103	7501.1103.070
	1,104	7501.1104.070
↓	↓	↓
	1,995	7501.1995.070
	1,996	7501.1996.070
	1,997	7501.1997.070
	1,998	7501.1998.070
	1,999	7501.1998.070
	2,000	7501.2000.070

Prüfstifte aus Hartmetall mit Halter




Pos.	Nominaldurchmesser	Sollwert (mm)	Istwert (mm)		Mittelwert (mm)	Bestellnummer
	Ø Tol. +/-0.0005 mm		1	2		
	0.2110	0.2110	0.2112	0.2113	0.21125	7504.0211.045



Artikel-Nr.	Inhalt	Ø Bereich (mm)	Steigung	Toleranz (mm)	Länge (mm)	inklusive Aufbewahrungskasten 70 x 140 x 240 mm
7504	95	0,05 - 1,00	0,01	± 0,0005	45	
7514	100	1,01 - 2,00	0,01	± 0,0005	45	

Ausführung: Die Prüfstifte werden in Laserbeschrifteten Kunststoffröhrchen und mit Prüfprotokoll geliefert.
Der Inhalt kann nach Ihren Angaben zusammengestellt werden.
Die Prüfstifte sind auch einzeln erhältlich.


Prüfstifte aus Hartmetall mit Halter




Steigung 0,001 mm		Länge 70 mm
Ø Tol. +/-0.0005mm	Ø Außen	Bestellnummer
	0,050	7504.0050.045
	0,051	7504.0051.045
	0,052	7504.0052.045
	0,053	7504.0053.045
	0,054	7504.0054.045
	0,055	7504.0055.045
↓	↓	↓
	0,099	7504.0099.045
	0,100	7504.0100.045
	0,101	7504.0101.045
	0,102	7504.0102.045
	0,103	7504.0103.045
	0,104	7504.0104.045
↓	↓	↓
	0,994	7504.0994.045
	0,995	7504.0995.045
	0,996	7504.0996.045
	0,997	7504.0997.045
	0,998	7504.0998.045
	0,999	7504.0999.045

Steigung 0,001 mm		Länge 70 mm
Ø Tol. +/-0.0005mm	Ø Außen	Bestellnummer
	1,000	7504.1000.045
	1,001	7504.1001.045
	1,002	7504.1002.045
	1,003	7504.1003.045
	1,004	7504.1004.045
	1,005	7504.1005.045
↓	↓	↓
	1,099	7504.1099.045
	1,100	7504.1100.045
	1,101	7504.1101.045
	1,102	7504.1102.045
	1,103	7504.1103.045
	1,104	7504.1104.045
↓	↓	↓
	1,995	7504.1995.045
	1,996	7504.1996.045
	1,997	7504.1997.045
	1,998	7504.1998.045
	1,999	7504.1999.045
	2,000	7504.2000.045

Prüfstifte aus Hartmetall mit Entlüftungsloch für Sacklöcher



Pos.	Nominaldurchmesser	Sollwert (mm)	Istwert (mm)		Mittelwert (mm)	Bestellnummer
	Ø Tol. +/-0.0005 mm		1	2		
	0.2110	0.2110	0.2112	0.2113	0.21125	7505.0211.070



Artikel-Nr.	Inhalt	Ø Bereich (mm)	Steigung	Toleranz (mm)	Länge (mm)	
7505	91	0,10 - 1,00	0,01	± 0,0005	70	inklusive Aufbewahrungskasten 105 x 140 x 240 mm
7515	100	1,01 - 2,00	0,01	± 0,0005	70	

Ausführung: Die Prüfstifte werden in Laserbeschrifteten Kunststoffröhrchen und mit Prüfprotokoll geliefert.
Der Inhalt kann nach Ihren Angaben zusammengestellt werden.
Die Prüfstifte sind auch einzeln erhältlich.


Prüfstifte aus Hartmetall mit Entlüftungsloch für Sacklöcher




Steigung 0,001 mm		Länge 70 mm
Ø Tol. +/-0.0005 mm	Ø Außen	Bestellnummer
	0,100	7505.0100.070
	0,101	7505.0101.070
	0,102	7505.0102.070
	0,103	7505.0103.070
	0,104	7505.0104.070
	0,105	7505.0105.070
↓	↓	↓
	0,500	7505.0500.070
	0,501	7505.0501.070
	0,502	7505.0502.070
	0,503	7505.0503.070
	0,504	7505.0504.070
	0,505	7505.0505.070
↓	↓	↓
	0,994	7505.0994.070
	0,995	7505.0995.070
	0,996	7505.0996.070
	0,997	7505.0997.070
	0,998	7505.0998.070
	0,999	7505.0999.070

Steigung 0,001 mm		Länge 70 mm
Ø Tol. +/-0.0005 mm	Ø Außen	Bestellnummer
	1,000	7505.1000.070
	1,001	7505.1001.070
	1,002	7505.1002.070
	1,003	7505.1003.070
	1,004	7505.1004.070
	1,005	7505.1005.070
↓	↓	↓
	1,099	7505.1099.070
	1,100	7505.1100.070
	1,101	7505.1101.070
	1,102	7505.1102.070
	1,103	7505.1103.070
	1,104	7505.1104.070
↓	↓	↓
	1,995	7505.1995.070
	1,996	7505.1996.070
	1,997	7505.1997.070
	1,998	7505.1998.070
	1,999	7505.1998.070
	2,000	7505.2000.070

Prüfstifte aus Hartmetall mit Entlüftungsloch für Sacklöcher mit Halter




Pos.	Nominaldurchmesser	Sollwert (mm)	Istwert (mm)		Mittelwert (mm)	Bestellnummer
	Ø Tol. +/-0.0005 mm		1	2		
	0.2110	0.2110	0.2112	0.2113	0.21125	7506.0211.045



Artikel-Nr.	Inhalt	Ø Bereich (mm)	Steigung	Toleranz (mm)	Länge (mm)	
7506	91	0,10 - 1,00	0,01	± 0,0005	45	inklusive Aufbewahrungskasten 70 x 140 x 240 mm
7516	100	1,01 - 2,00	0,01	± 0,0005	45	

Ausführung: Die Prüfstifte werden in Laserbeschrifteten Kunststoffröhrchen und mit Prüfprotokoll geliefert.
Der Inhalt kann nach Ihren Angaben zusammengestellt werden.
Die Prüfstifte sind auch einzeln erhältlich.


Prüfstifte aus Hartmetall mit Entlüftungsloch für Sacklöcher mit Halter



Steigung 0,001 mm		Länge 70 mm
Ø Tol. +/-0.0005mm	Ø Außen	Bestellnummer
	0,050	7506.0050.045
	0,051	7506.0051.045
	0,052	7506.0052.045
	0,053	7506.0053.045
	0,054	7506.0054.045
	0,055	7506.0055.045
↓	↓	↓
	0,099	7506.0099.045
	0,100	7506.0100.045
	0,101	7506.0101.045
	0,102	7506.0102.045
	0,103	7506.0103.045
	0,104	7506.0104.045
↓	↓	↓
	0,994	7506.0994.045
	0,995	7506.0995.045
	0,996	7506.0996.045
	0,997	7506.0997.045
	0,998	7506.0998.045
	0 999	7506.0999.045


Steigung 0,001 mm		Länge 70 mm
Ø Tol. +/-0.0005mm	Ø Außen	Bestellnummer
	1,000	7506.1000.045
	1,001	7506.1001.045
	1,002	7506.1002.045
	1,003	7506.1003.045
	1,004	7506.1004.045
	1,005	7506.1005.045
↓	↓	↓
	1,099	7506.1099.045
	1,100	7506.1100.045
	1,101	7506.1101.045
	1,102	7506.1102.045
	1,103	7506.1103.045
	1,104	7506.1104.045
↓	↓	↓
	1,995	7506.1995.045
	1,996	7506.1996.045
	1,997	7506.1997.045
	1,998	7506.1998.045
	1,999	7506.1998.045
	2,000	7506.2000.045

Halter für Hartmetallprüfstifte



Typ	Ø Innen mm	Länge mm	Bestellnummer
1	0,05 - 0,09	40	7526.0050.040
2	0,10 - 0,19	40	7526.0100.040
3	0,20 - 0,28	40	7526.0200.040
4	0,29 - 0,38	40	7526.0290.040
5	0,39 - 0,49	40	7526.0390.040
6	0,50 - 0,59	40	7526.0500.040
7	0,60 - 0,79	40	7526.0600.040
8	0,80 - 1,00	40	7526.0800.040

Halter für Prüfstifte aus Hartmetall mit Entlüftungsloch für Sacklöcher

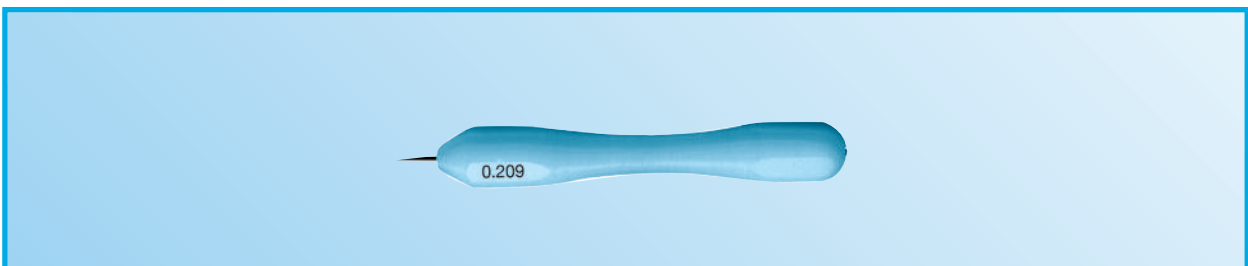

Typ	Ø Innen mm	Länge mm	Bestellnummer
1	0,05 - 0,09	40	7536.0050.040
2	0,10 - 0,19	40	7536.0100.040
3	0,20 - 0,28	40	7536.0200.040
4	0,29 - 0,38	40	7536.0290.040
5	0,39 - 0,49	40	7536.0390.040
6	0,50 - 0,59	40	7536.0500.040
7	0,60 - 0,79	40	7536.0600.040
8	0,80 - 1,00	40	7536.0800.040